




POWER ANDULLATOR

Aansluiten van de Power Andullator

- > De Power Andullator is optioneel verkrijgbaar bij de Andumedic.

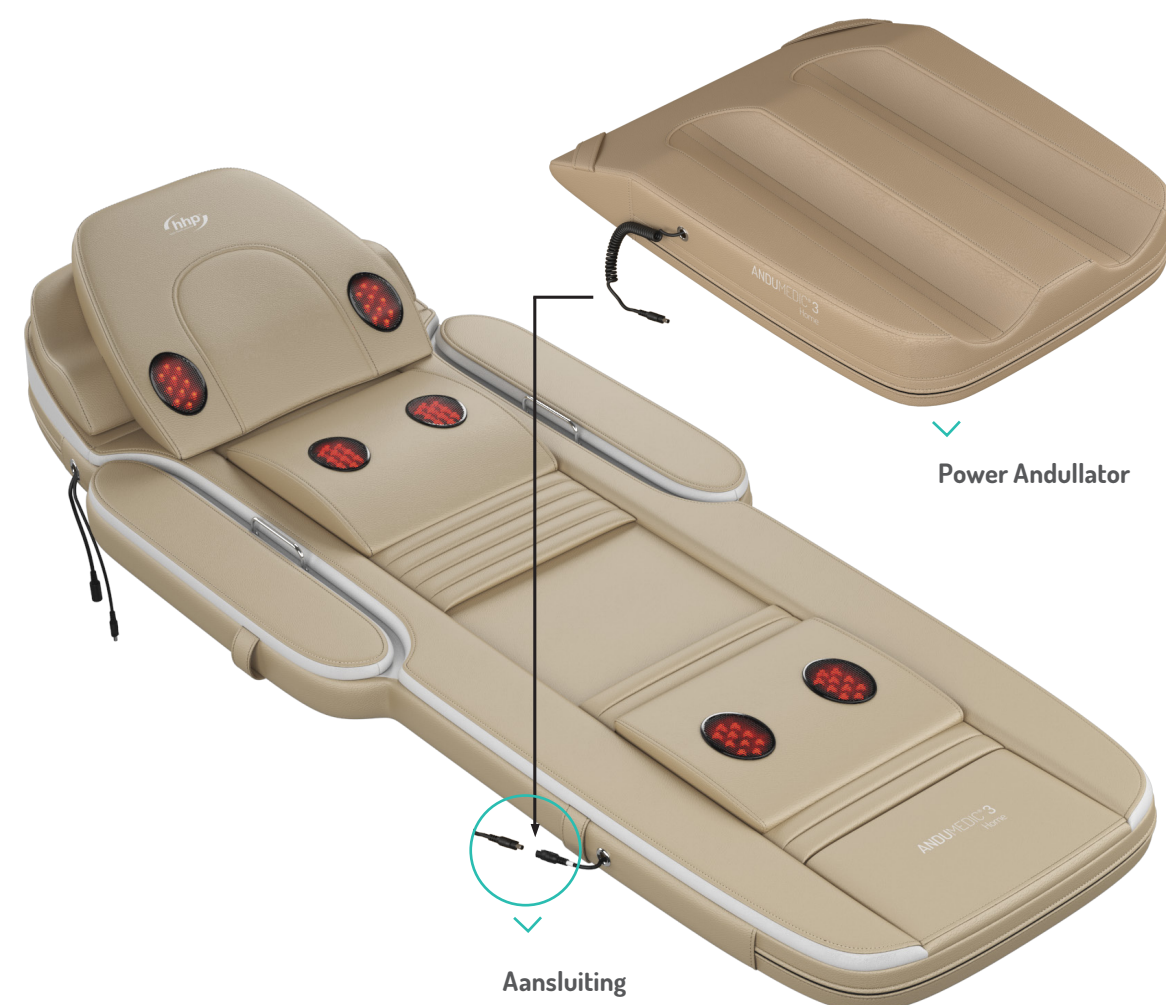

- > **Let op!** De Power Andullator en het infrarood voor de voeten kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden. Gelieve dus de Power Andullator los te koppelen om de voetreflexologie te kunnen gebruiken.



POSITIONERING

Behandeling van het volledige lichaam



- > Toepassing met de Power Andullator

Voetreflexologische stimulatie



- > Schuif het balanskussen zo onder uw ANDUMEDIC dat de schuine kant van het kussen zich precies onder het voetenkussen bevindt.

Programma 06

- > **Voetreflexologische stimulatie**

Bij circulatieproblemen in de onderbenen en voeten; vermindering van de pijn; stimulatie van de lymfestroom en de bloedsomloop; versterking van het immuunsysteem.

Voor het gebruik van de voetreflexologie: **gelieve de powerandullator te ontkoppelen.**



Gebruiksaanwijzing ANDUMEDIC® 3

Add a smile to your life 😊

THERAPIEPROGRAMMA'S VAN PROF. DR. STUTZ

Basisprogramma's

BASISPROGRAMMAS	P01	Opwarmen	Om op te warmen; om spieren los te maken.
	P02	Dieptewerkende spierandullatie	Verzachten van spierpijn en krampen; vitaliserend, bevordert het lichamelijk welbevinden; stimulatie van de stofwisseling.
	P03	Stimulatie van het lymfesysteem	Stimulatie van de lymfestroom; afbreken van metabole eindproducten; stimulatie van de ontgiftiging en ontzuring; ondersteuning van de veneuze terugstroom; verstevigt het bindweefsel; helpt bij cellulitis.
	P04	Impuls-andullatie	Losmaken van spierkrampen; stimulatie van de doorbloeding.
	P05	Ontspanning	Diepgaande ontspanning; afbouw van stress en verse energie opdoen; activatie van de lichaamseigen, zelfhelende krachten; helpt bij slaapproblemen.
	P06	Stimulering van de voetreflexzones	Tegen doorbloedingsstoornissen in de onderbenen en voeten, verzachten van pijn; stimulatie van de lymfestroom en bloedcirculatie; versterking van het immuunsysteem.


Medische programma's

MEDISCHE PROGRAMMAS	P07	Verhardingen versoepelen	Bij rugklachten en verhardingen in de rugspieren; oplossen van myogelosen.
	P08	Chronische rugklachten	Bij chronische klachten in het gebied van de lendenwervelkolom; ischiasklachten.
	P09	Ontspanning van de nek	Bij spanningshoofdpijn, migraine en ter ontspanning van de nekspieren, tegen schouderpijn.
	P10	Gewrichten mobiliseren	Bij gewrichtspijnen; artrose en reuma; bij osteoporose.
	P11	Powernap	Vermindert stress en daardoor ook het risico op een burn-out; ontspant onmiddellijk.
	P12	Stofwisseling activeren	Stofwisselingsprocessen worden geactiveerd, bv. bij gewichtsproblemen; tegen spijsverteringsstoornissen; ter behandeling van gezwollen benen.
	P13	Recuperatie na het sporten	Sneller herstel na het sporten en na fysieke inspanning; verzachten van spierpijn; ondersteunt de afbraak van metabole eindproducten.
	P14	Doelgerichte behandeling van het viscerale vet	Uit te voeren met strak aangespannen andullatiegordel - Stimulatie van de darmactiviteit bij spijsverteringsproblemen; verbetert de doorbloeding van inwendige organen; stimulatie van het buikspierstelsel, vermindering van ontstekingskernen in het viscerale vet.
	P15	Fibromyalgie, CVS, spasmofilie	Verzachten van spierpijn en krampen, vermindering van stress en ontspanning; bij inslaap- of doorslaapproblemen; en heeft een positieve invloed op het autonome zenuwstelsel.
	P16	Bloedsomloop stimuleren	Ondersteunt de bloedsomloop op een positieve manier; stimuleert en vitaliseert.
	P17	Acute pijn verminderen	Gebruik bij spit en bij kuitkrampen
	P18	Slaapproblemen verhelpen	Vermindert specifieke slaapproblemen; helpt om de dagelijkse spanningen af te bouwen.
	P19	Weefsel ontspannen	Spanningen in de meest uiteenlopende weefseltypen worden verminderd; verhelpt blokkades.
	P20	Stresstolerantie	Maakt het vegetatieve afweersysteem stressbestendiger; versterkt de stresstolerantie.



BEDIENING

Andumedic

Stap 1

 **Timer** - Druk op deze toets om de duur van de therapie (15/30 min) in te stellen.

Stap 2

  **P/ON** - Druk op deze toets en stel het gewenste programma (P01 - P20) in door op +/- te drukken.






Stap 3

  Het NIR (Near-infrared) is in de standaardinstellingen uitgeschakeld. **H1** - Druk op deze toets om het NIR in te schakelen ter hoogte van het nek- en lendenwervelkolomkussen. De **H2**-toets dient voor het bedienen van het NIR ter hoogte van de kuiten. Om de intensiteit te verhogen of te verlagen moet u de betreffende toets opnieuw indrukken. De symbolen boven de **H1**-/**H2**-toetsen geven de huidige instelling aan.

Uitschakelen

 **OFF** - Druk op de **OFF**-toets om het systeem uit te schakelen.

De intensiteit instellen

 Zones 1 tot 5 kunnen afzonderlijk met de betreffende toetsen worden ingesteld.
 Druk daarvoor op de overeenkomstige toets en stel met +/- de intensiteit in. U kunt het met die toetsen ook volledig uitschakelen.
   Druk op Golf 2 - 5 en stel met +/- de gewenste intensiteit van zones 1 tot 5 in. Op de display wordt de intensiteit weergegeven (1 = laag, 7 = hoog).

